


デジタルポスター会場案内図

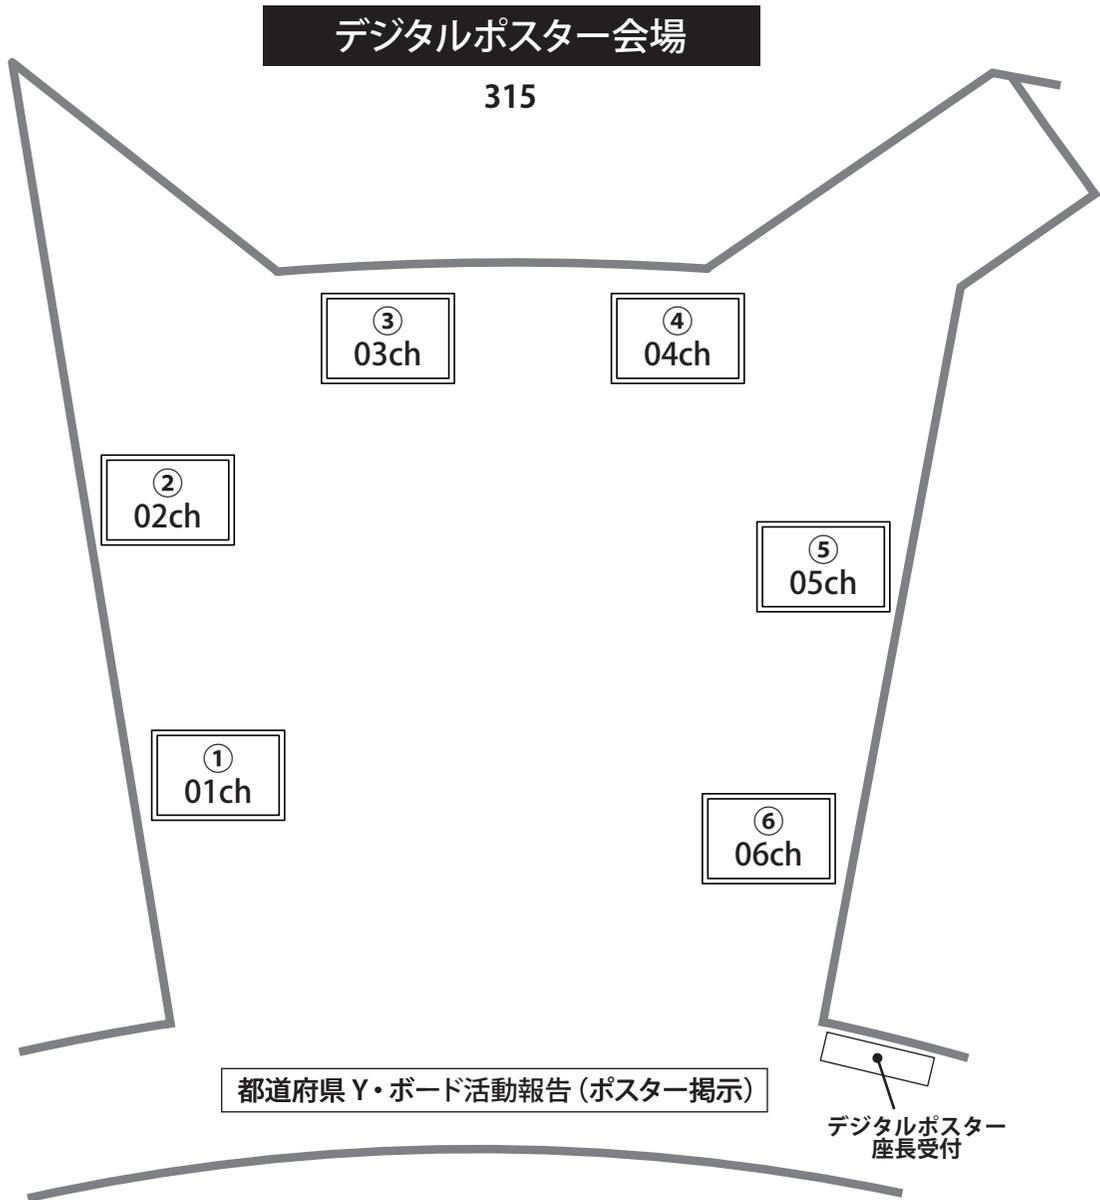

聴講レシーバー使用方法

デジタルポスター会場では、マイクの音声は聴講レシーバーを用いて聴講していただきます。座長・演者の方もこちらを使用してください。

ブース毎にチャンネル (CH) が異なりますのでデジタルポスター発表時間一覧 (P.15) をご確認ください

■ご退出時は、必ずご返却くださいますようお願いいたします。

ボリューム
上下にスライドしてお好みの音量に合わせてください。

チャンネル切替
お聞きになられるチャンネルをお選びください。



受光部

電源

講演開始時に1回押してください。イヤホンジャックを抜くと電源はOFFになります。

デジタルポスター発表時間一覧

5月26日(土)

デジタルポスターブース	ブース1	ブース2	ブース3	ブース4	ブース5	ブース6
聴講レシーバーCH	CH01	CH02	CH03	CH04	CH05	CH06
AM	9:50~10:40 血液透析 (清浄化) DP-001~DP-005	9:50~10:40 心臓カテーテル (EVT) DP-016~DP-020	9:50~10:40 集中治療 (評価・呼吸管理) DP-031~DP-035	9:50~10:40 ME 機器 (管理) DP-046~DP-050	9:50~10:40 医療安全 (教育1) DP-062~DP-066	9:50~10:50 人工呼吸器 (教育・管理) DP-078~DP-083
	10:40~11:30 血液透析 (症例報告) DP-006~DP-010	10:40~11:30 不整脈 (ペースメーカー) DP-021~DP-025	10:40~11:30 高気圧酸素 DP-036~DP-040	10:40~11:30 ME 機器 (不具合事例1) DP-051~DP-055	10:40~11:30 組織・教育 DP-067~DP-071	10:50~11:50 人工呼吸器 (使用・症例報告) DP-084~DP-089
	11:30~12:20 血液透析 (装置管理) DP-011~DP-015	11:30~12:20 不整脈 (マネジメント) DP-026~DP-030	11:30~12:20 内視鏡 (評価・管理) DP-041~DP-045	11:30~12:30 手術室(神経・筋 モニタリング1) DP-056~DP-061	11:30~12:30 医療安全 (教育2) DP-072~DP-077	
PM	16:20~17:20 血液透析 (患者管理) DP-090~DP-095	16:20~17:20 不整脈 (症例報告1) DP-101~DP-106	16:20~17:20 内視鏡 (業務) DP-112~DP-117	16:20~17:20 手術室 (評価) DP-124~DP-129	16:20~17:20 ME 機器 (評価) DP-136~DP-141	16:20~17:20 活動報告 DP-148~DP-153
	17:20~18:10 血液透析 (安全・その他) DP-096~DP-100	17:20~18:10 不整脈 (ICM) DP-107~DP-111	17:20~18:20 手術室 (内視鏡外科) DP-118~DP-123	17:20~18:20 人工心肺 (評価・症例報告) DP-130~DP-135	17:20~18:20 ME 機器 (安全管理1) DP-142~DP-147	17:20~18:20 教育 (志望者拡大) DP-154~DP-159

5月27日(日)

デジタルポスターブース	ブース1	ブース2	ブース3	ブース4	ブース5	ブース6
聴講レシーバーCH	CH01	CH02	CH03	CH04	CH05	CH06
AM	9:50~10:50 急性血液浄化 (症例報告・安全) DP-160~DP-165	9:50~10:50 不整脈 (CRT) DP-172~DP-177	9:50~10:50 手術室 (ナビゲーション) DP-184~DP-189	9:50~10:40 ME 機器 (管理ソフト1) DP-196~DP-200	9:50~10:50 人工呼吸器 (在宅・災害対策) DP-207~DP-212	9:50~10:40 補助循環 (評価・症例報告) DP-219~DP-223
	10:50~11:50 血液透析(パス キュラーアクセス) DP-166~DP-171	10:50~11:50 不整脈 (症例報告2) DP-178~DP-183	10:50~11:50 手術室 (取り組み) DP-190~DP-195	10:50~11:50 ME 機器 (管理ソフト2) DP-201~DP-206	10:50~11:50 ME 機器 (生体情報モニタ) DP-213~DP-218	10:50~11:50 人工心肺 (管理・教育) DP-224~DP-229
PM	13:20~14:20 血液浄化 (CAPD・その他) DP-230~DP-235	13:20~14:20 不整脈 (トラブル) DP-241~DP-246	13:20~14:20 手術室 (管理・事例) DP-253~DP-258	13:20~14:20 ME 機器 (不具合事例2) DP-265~DP-270	13:20~14:20 勤務体制 DP-276~DP-281	
	14:20~15:10 アフレスिस (CART) DP-236~DP-240	14:20~15:20 循環器 (その他) DP-247~DP-252	14:20~15:20 手術室(神経・ 筋モニタリング2) DP-259~DP-264	14:20~15:10 ME 機器 (安全管理2) DP-271~DP-275		